

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 5.153.6!

## Разпечатайте указанията като кликнете на този надпис

### • Дейности

Актуализирани са дейностите във връзка с Договор № РД-НС-01-4-14 от 24 август 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Добавени са следните кодове на изследвания:


01.43	92212-00	Определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HBsAg) с бърз тест
01.44	92212-01	Определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест.
10.79	91939-16	Фекален калпротектин
10.80	91918-07	PSA свободен
05.12	92191-01	Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2

Добавена е следната ВСД процедура 75.39 35504-00 Фетална морфология.


### • За лаборатории

Във връзка с новото изследване 05.12 92191-01 Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 и за старото 10.64 Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, преди да започнете да ги изпълнявате през менюто Входящи->МДН трябва да направите следните настройки:

1. Влизате в Инструменти->НЗИС и от появилият се прозорец избирате зъбното колелце за настройки:

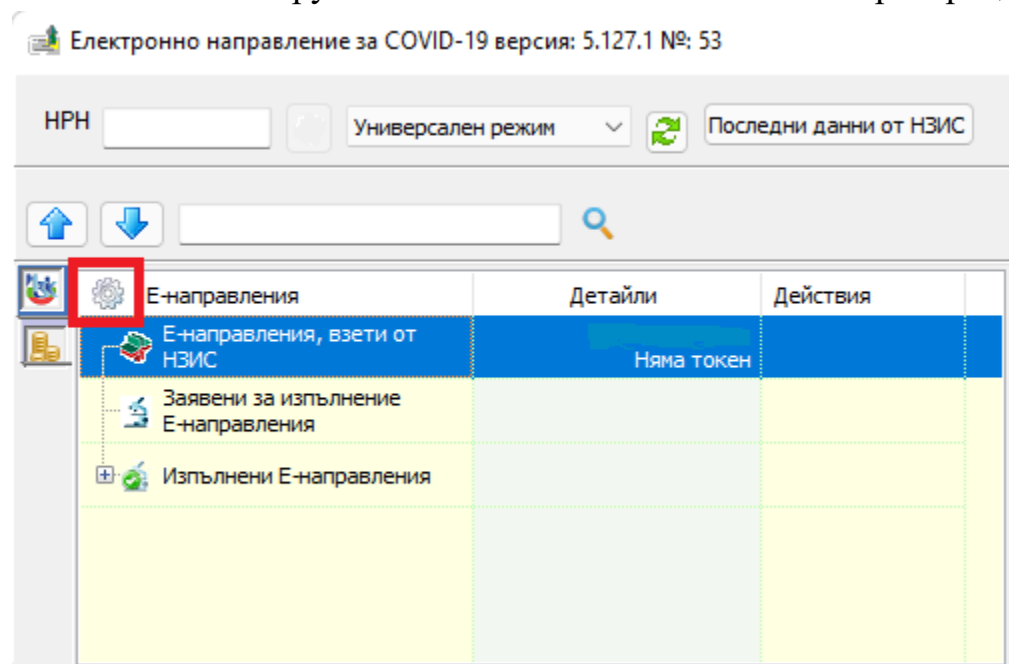



2. От **Вид на тест за COVID-19** избирате, този/тези тестове, които правите във Вашата лаборатория, като слагате отметка пред самия тест и задавате времето, за което се извършва обработката му:

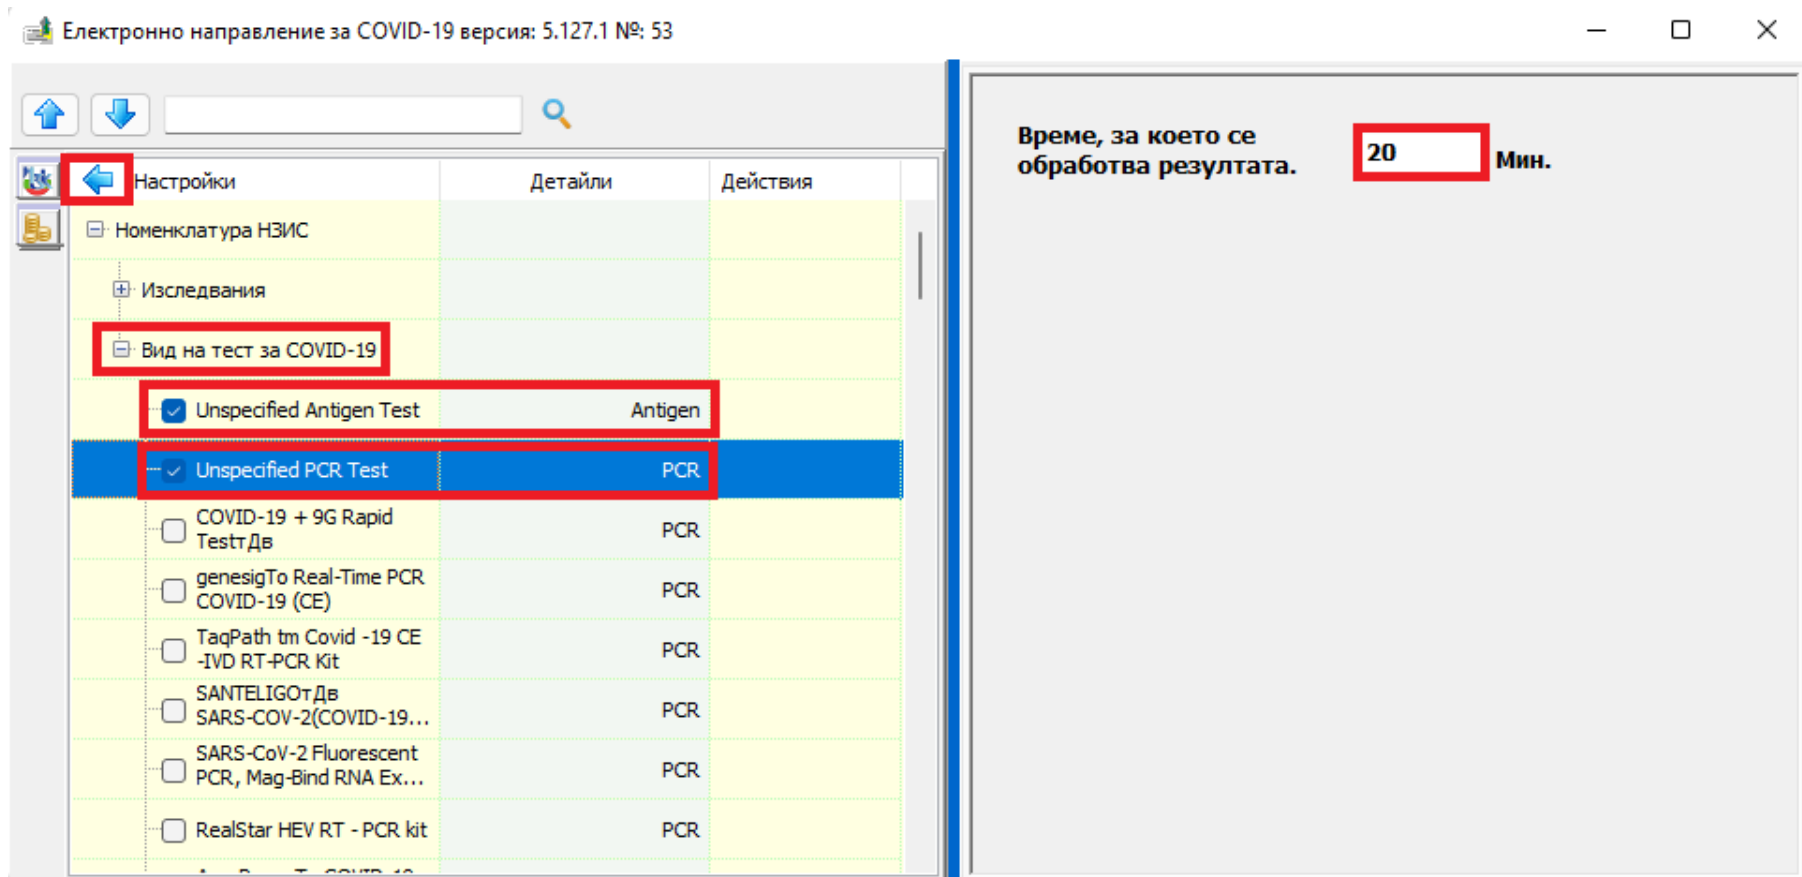

След като направите избора си, се връщате от бутона стрелка назад  **Настройки**.

Изпълняват се както другите изследвания по познатия начин:

Входящи->МДН->Взимане на МДН:

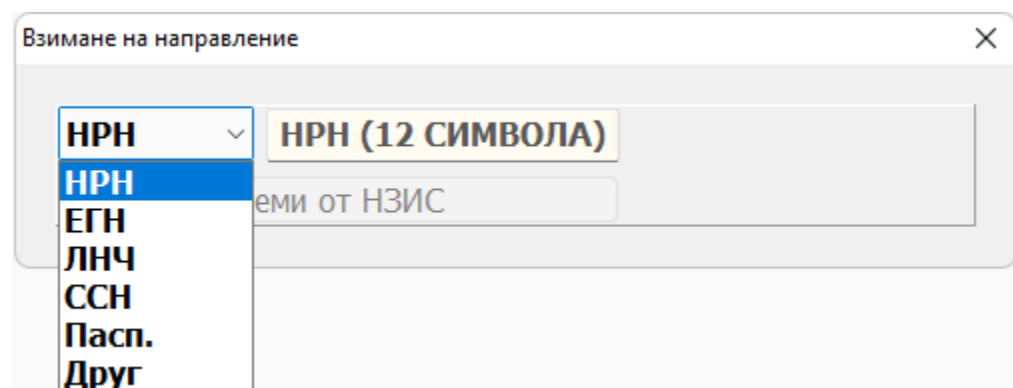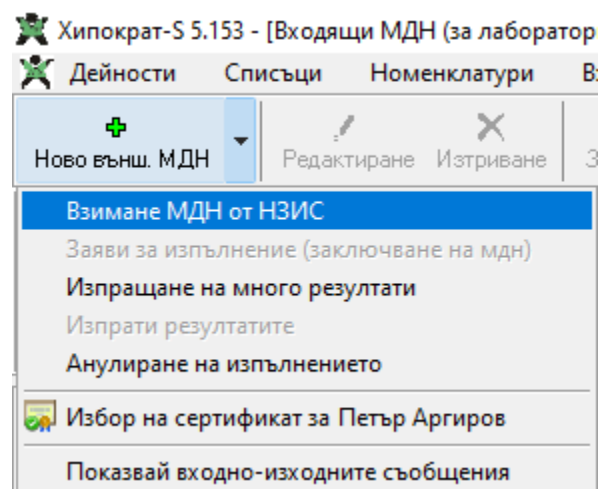

При взимането на 05.12 и 10.64 излиза прозорче за избор на пакета, защото тези изследвания присъстват в два пакета.

За да се изпратят резултатите успешно към НЗИС, в полето Резултат трябва да се въведе, ако резултата е положителен "Положителен" или съкратено "Полож."

Съответно ако резултата е отрицателен, "Отрицателен" или съкратено "Отриц." В противен случай ако се въведе нещо друго, няма да се изпратят резултатите и ще възникне грешка при изпращането на резултатите към НЗИС. Също така, НЗИС не позволява корекция на резултата за тези две изследвания. Връща се грешка от НЗИС: "Не може да подавате коригираща заявка за COVID".

Код	Пълен код	Цена	Наименование	Резултат	Св.приен	Изпълнено	Стойност	Min	Max	Отхв. НЗОК	Реф. ст. - описание
▶12	05.12	10	Тест за откриване на антиген на SARS	Отриц.	Не	Да		0	0	Не	

Код	Пълен код	Цена	Наименование	Резултат	Св.приен	Изпълнено	Стойност	Min	Max	Отхв. НЗОК	Реф. ст. - описание
▶12	05.12	10	Тест за откриване на антиген на SARS	Полож.	Не	Да		0	0	Не	